AtmosAir Velaris

CE UK CA 2797 0086

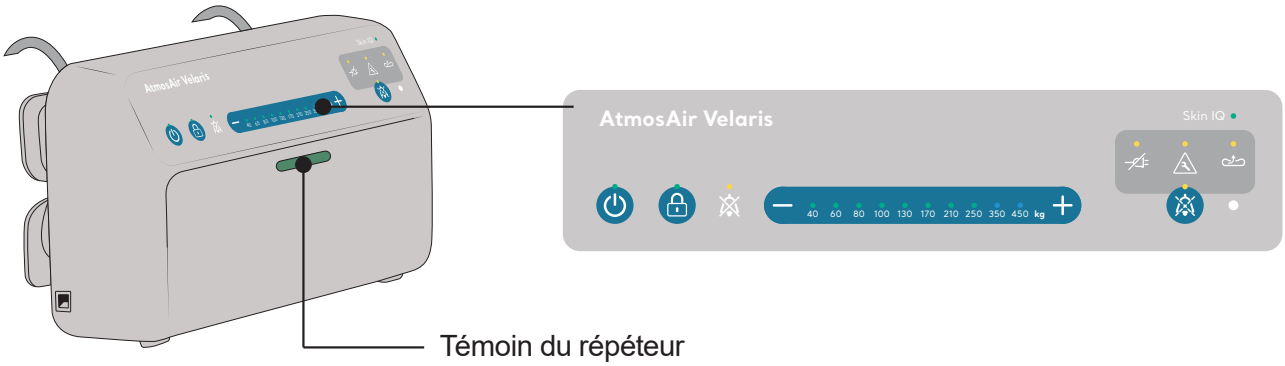

Bouton et témoin Marche/Veille

Le bouton Marche/Veille permet de faire passer la pompe du mode marche au mode veille.

En mode Marche, le témoin s'allume.

Pour le mode Veille, appuyez sur le bouton pendant deux secondes. Le témoin s'éteint.

Bouton et témoin de verrouillage

Pour verrouiller le panneau de commande, appuyez sur le bouton de verrouillage pendant 2 secondes. Une fois verrouillé, le témoin s'allume.

Pour déverrouiller tous les boutons du panneau de commande, appuyez sur le bouton de verrouillage pendant deux secondes. Une fois le panneau déverrouillé, le témoin s'éteint.

Témoin de désactivation du son

Le témoin de désactivation du son s'allume lorsque les notifications sonores et les alertes ont été désactivées de façon permanente.

Boutons et témoin de sélection du poids

Le poids est défini par défaut et affiche une valeur de 100 kg (220 lb).

- Appuyez sur le bouton – pour réduire le poids du patient.
- Appuyer sur le bouton + pour augmenter le poids du patient.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Bouton et témoin de mise en pause de l’alerte sonore

Appuyez sur le bouton de mise en pause de l’alerte sonore pour couper le son de l’alerte pendant 15 minutes ; le témoin s’allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler la mise en pause de l’alerte.

Témoin indiquant une panne de courant

Si une panne de courant est détectée, le témoin indiquant une panne de courant s’allume et une alerte retentit.

En cas de panne de courant, la thérapie active (à pression alternée) ne peut être réalisée.

Témoin indiquant une défaillance du système

Si une défaillance interne de la pompe est détectée pendant l’autotest intégré (BIST) ou pendant la thérapie, le témoin de défaillance du système s’allume et une alerte retentit.

Alerte de pression basse

Si le matelas n’atteint pas la pression cible, le témoin indiquant une pression basse s’allume et une alerte retentit.

Témoin Skin-IQ

Les témoins Skin-IQ s’allument lorsqu’une housse Skin-IQ est connectée au port de prise d’alimentation du Skin IQ.