Auralis

CE 2797 UK CA 0086

Matratzenauflage oder Matratzenersatz sowie Kompressor installieren

1



- Schlauchleitung am Fußende
- CPR am Kopfende
- Zellen zeigen nach oben



Matratzenauflage:
Auf der Basismatratze platzieren.

Mit 4 Befestigungsbändern fixieren.

Matratzenersatz:
Auf dem Bettgestell platzieren.
Befestigen Sie die 8 Befestigungsbänder an den beweglichen Teilen des Bettrahmens (+ 3 am Kopfende nur bei Auralis Plus).

2

Befestigen Sie den Schutzbezug auf der Matratze. Dabei sollte das Arjo-Logo am Fußende sichtbar sein.

3

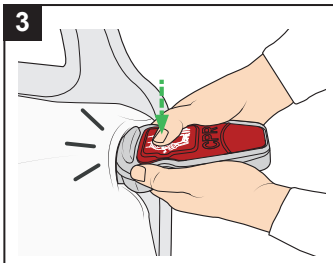

Die CPR-Einheit ist in der geschlossenen Stellung eingerastet.

4



Hängen Sie den Kompressor am Fußende des Bettes ein.

5



Schlauchleitung anschließen.

6



Legen Sie das Kabel in die Kabelführung. Schließen Sie mit den Druckknöpfen die Lasche um das Kabel.

Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle an.

Sitzkissen und Kompressor installieren

1

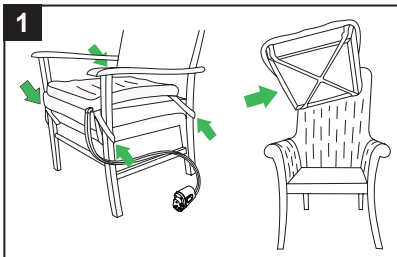



Sitzkissen:

Auf der Stuhloberfläche platzieren.

Mit den Befestigungsbändern fixieren.

- Zellen zeigen nach oben
- Schlauchleitung an der vorderen rechten Ecke
- Zellen horizontal über dem Stuhl, V-Form zeigt nach vorne

2

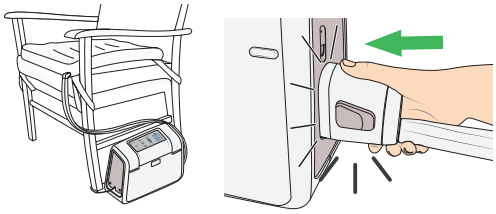

Stellen Sie den Kompressor auf den Boden, mit dem Kabel unter dem Stuhl und den Schlauchleitungen neben dem Stuhl.

Schlauchleitung anschließen.

Schließen Sie das Netzkabel an eine Stromquelle an.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Inbetriebnahme des Auralis Systems

1

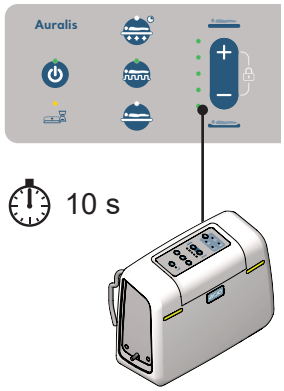

Wenn der Kompressor an eine Stromquelle angeschlossen ist, führt er einen Selbsttest durch: Signalton – 10 Sekunden – 2 Signaltöne – betriebsbereit.

Halten Sie die Betrieb/Standby-Taste gedrückt.

Dort sind folgende Anzeigen zu sehen:

- Betrieb/Standby
- Warteanzeige
- Taste für Wechseldruckmodus
- Komfort-Bedienanzeige
- Akku-Ladeanzeige
- Grüne Anzeigen auf der Vorderseite des Kompressors

2

Sobald die Warteanzeige erlischt, legen Sie das Bettlaken auf die Matratze. Vergewissern Sie sich, dass die CPR-Schnellentlüftung deutlich sichtbar ist.

Legen Sie den Patienten auf die Matratze oder das Sitzkissen.

Der Wechseldruckmodus ist standardmäßig eingestellt.

CPR-Schnellentlüftung

1

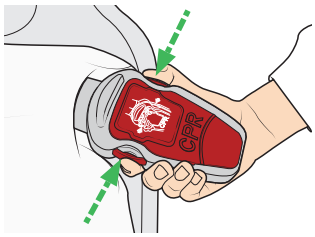

Aktivierung: Drücken Sie gleichzeitig beide CPR-Freigabetasten.

2

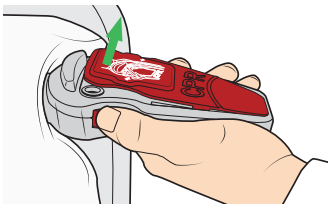

Vergewissern Sie sich, dass die Vorderseite geöffnet ist. Die Luft entweicht schnell.

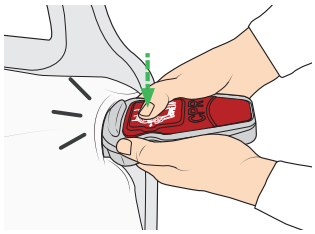

Reset: Drücken Sie den offenen Teil nach unten, bis er in der geschlossenen Position einrastet.

AutoFirm-Modus

1



Aktivierung: Halten Sie die Taste gedrückt.

Komfort-Anzeigen blinken und die Matratze wird aufgepumpt, bis sie den AutoFirm-Druck erreicht.

2

Druck erreicht – AutoFirm- und Komfortbedienungs-Anzeigen leuchten durchgehend.



Deaktivierung: Taste gedrückt halten oder einen anderen Modus auswählen.

Verlängern: Drücken Sie diese Taste, um den Modus um 5 Minuten zu verlängern. Max. 30 Minuten.

Wird er nicht verlängert, kehrt der Kompressor in den vorherigen Modus zurück.

Wechseldruckmodus, Standardeinstellung

Aktivierung:

Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige für den Wechseldruckmodus aufleuchtet.

Nebeneinander liegende Zellen werden im 10-Minuten-Takt aufgepumpt und entlüftet.

Deaktivierung:

Reaktiven Weichlagerungs- oder AutoFirm-Modus auswählen.

Ist keine weitere Therapie erforderlich, lagern Sie den Patienten auf eine andere Unterlage um und schalten Sie den Kompressor aus.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Reaktiver Weichlagerungsmodus

Aktivierung:

Halten Sie die Taste gedrückt.

Die Anzeige für den reaktiven Weichlagerungsmodus leuchtet.

Deaktivierung:

Wechseldruck- oder AutoFirm-Modus auswählen.

Ist keine weitere Therapie erforderlich, lagern Sie den Patienten auf eine andere Unterlage um und schalten Sie den Kompressor aus.

Sperrmodus



Sperren:

Drücken und halten Sie die Komfortfunktionstasten gleichzeitig.

Komfort-Bedienanzeige blinkt.

Der Kompressor ist nun gesperrt.



Entsperren:

Drücken und halten Sie die Komfortfunktionstasten gleichzeitig.

Komfort-Bedienanzeige blinkt.

Der Kompressor ist nun entsperrt.

Transportmodus (nur Matratzen)



Aktivierung:

Drücken Sie die Seitentasten gleichzeitig und entfernen Sie die Schlauchleitung.

Die Matratze stützt den Patienten bis zu 12 Stunden.



Deaktivierung:

Schließen Sie die Schlauchleitung wieder an.

Der Kompressor kehrt in den vorherigen Modus zurück.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Aufpumpen und Entlüften des Polsters (nur Auralis Plus)

Polsterkonfigurationen:

- Ein Polster ist aufgepumpt (links oder rechts)
- Beide Polster sind aufgepumpt (links und rechts)
- Beide Polster sind entlüftet (links und rechts)

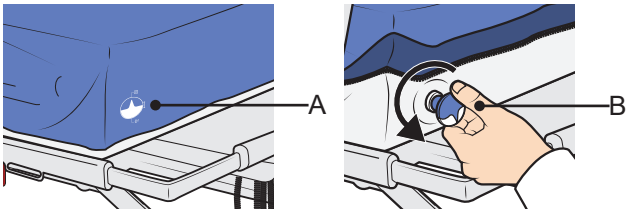

Risiko für Verletzungen oder Schmerzen
Transportmodus deaktivieren

Aufpumpen des Polsters:

Suchen Sie das Ventilsymbol (A).

Drehen Sie das Ventil (B) am Polster vollständig gegen den Uhrzeigersinn.

Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls am anderen Polster.

Acht Minuten aufpumpen lassen.

Hinweis: Verlängerter Bettrahmen, bevor die Polster aufgepumpt werden.

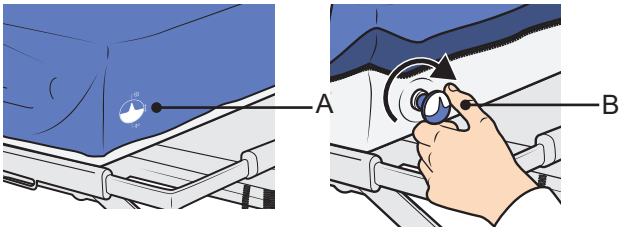

Ablassen der Luft aus dem Polster:

Suchen Sie das Ventilsymbol (A).

Drehen Sie das Ventil (B) am Polster vollständig im Uhrzeigersinn.

Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls am anderen Polster.

Fünf Minuten entlüften lassen.

Hinweis: Lassen Sie die Luft aus den Polstern ab, bevor Sie die Bettrahmenbreite verkleinern.