System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797 UK CA 0086

Reinigen und Desinfizieren:
– mit Desinfektionsgerät (Still Bath und Hydrosound-System) S. 1–2
– mit Sprühflasche (Still Bath und Hydrosound-System), Seite 3
– das Hydromassage-System mit automatischer Desinfektion, Seite 4
– das Hydromassage-System ohne automatische Desinfektion, Seite 5

Mit Desinfektionsgerät reinigen und desinfizieren (Still Bath und Hydrosound-System)

Entfernen sichtbarer Rückstände

1

Füllstand des Desinfektionsmittels überprüfen.

2

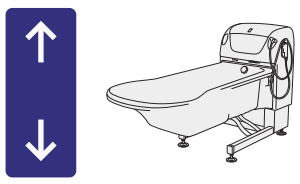

Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.

3

Sicherstellen, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind.

4



Öffnen Sie den Abfluss. Nehmen Sie alle Zubehörkomponenten ab und legen Sie sie auf den Boden der Badewanne.

5

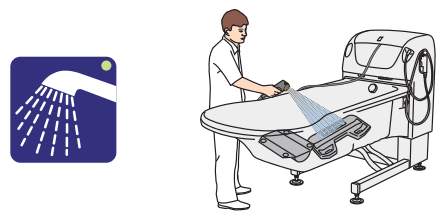

Spülen Sie die Badewanne und das Zubehör mit Wasser ab, um sichtbare Rückstände zu entfernen. Zubehör auch von der anderen Seite abspülen.

Reinigung

6



Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.

7



Heben Sie den Desinfektionssprühgriff heraus.

8

Die Desinfektionstaste drücken.

9

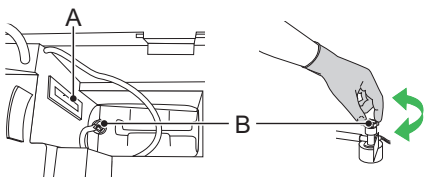

Sprühen Sie Desinfektionsmittel in die Badewanne, bis der Durchflussmesser (A) den gemäß der Bedienungsanleitung richtigen Mischungswert anzeigt. Falls notwendig anpassen (B).

10

°C (°F)

Stellen Sie die Temperatur des Wassers auf etwa 25 °C ein, um die Desinfektionsmitteldämpfe zu beseitigen.

11

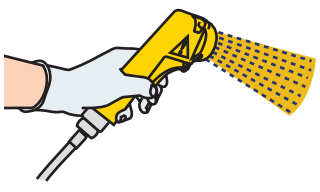

Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Schrubben Sie den Ablauf mit einer Bürste.

12



Schließen Sie den Abfluss.

13



Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.

14



Sprühen Sie in die Überlauföffnung.

15

Zum Ausschalten die Desinfektionstaste drücken.

16



Reinigen Sie die Oberflächen der Badewanne, der losen Teile und des Zubehörs gründlich mit einer weichen Bürste.

17



Öffnen Sie den Abfluss.

18

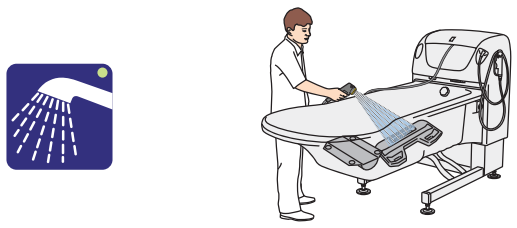

Spülen Sie alle Teile mit reichlich Wasser bei einer Temperatur von ca. 25 °C ab.

19

Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit alle anderen Kontaktbereiche ab: Außenseite der Badewanne, Handbedienung und Metallsensoren.

20

Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.



Fahren Sie mit „Desinfektion von *Still Bath und Hydrosound-System*“ *auf Seite 2* fort.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Reinigen/Desinfizieren

21

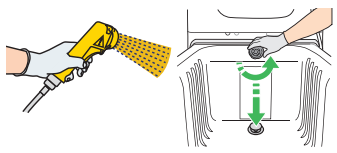

Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Schließen Sie den Abfluss.

22

Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.

Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.



23

Drücken Sie die Taste für die Desinfektion, um den Desinfektionszyklus zu beenden.

Nur automatische Desinfektion:
Wenn die voreingestellte Desinfektionszeit nicht abgelaufen ist, werden andere Funktionen je nach Modell 2–10 Minuten lang deaktiviert.

24



Stellen Sie den Desinfektionssprühgriff zurück.

25



Öffnen Sie den Abfluss.
Spülen Sie alle Teile mit Wasser bei einer Temperatur von 25 °C ab.

26

Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie alle anderen Kontaktbereiche ab: die Außenseite der Badewanne, die Handbedienung und die Metallsensorgriffe.

Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.



27

Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.



28

Lassen Sie es lufttrocknen.
Bringen Sie eventuelles Zubehör an.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Reinigung und Desinfektion mit einer Sprühflasche

Entfernen sichtbarer Rückstände

1



Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.

2

Sicherstellen, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind.

3



Öffnen Sie den Abfluss.
Nehmen Sie alle Zubehörkomponenten ab und legen Sie sie auf den Boden der Badewanne.

4



Spülen Sie die Badewanne und das Zubehör mit Wasser ab, um sichtbare Rückstände zu entfernen. Zubehör auch von der anderen Seite abspülen.

Reinigung

5

Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.

6

Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Schrubben Sie den Ablauf mit einer Bürste.

7



Schließen Sie den Abfluss.

8



Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.

9



Sprühen Sie in die Überlauföffnung.

10



Reinigen Sie die Oberflächen der Badewanne, der losen Teile und des Zubehörs gründlich mit einer weichen Bürste.

11



Öffnen Sie den Abfluss.

12



Spülen Sie alle Teile mit viel Wasser bei einer Temperatur von 25 °C ab.

13

Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit alle anderen Kontaktbereiche ab: Außenseite der Badewanne, Handbedienung und Metallsensoren.



14

Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.



Reinigen/Desinfizieren

15

Sprühen Sie Desinfektionsmittel in den Ablauf. Schließen Sie den Abfluss.

16

Besprühen Sie alle Innenflächen der Badewanne und alle Seiten der Zubehörteile.



17

Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.

18



Öffnen Sie den Abfluss.

19

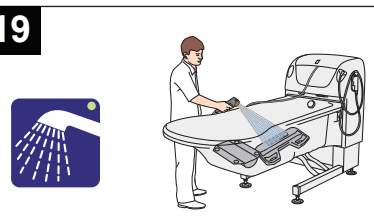

Spülen Sie alle Teile mit viel Wasser bei einer Temperatur von 25 °C ab.

20

Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel und wischen Sie damit alle anderen Kontaktbereiche ab: Außenseite der Badewanne, Handbedienung und Metallsensoren.

21

Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.

22

Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser und entfernen Sie das Desinfektionsmittel. Spülen Sie das Tuch regelmäßig unter laufendem Wasser aus.



23

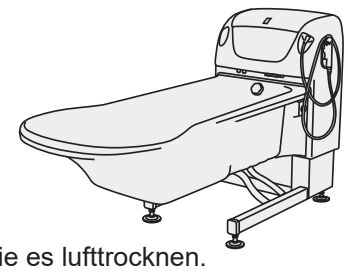

Lassen Sie es lufttrocknen.
Bringen Sie eventuelles Zubehör an.

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Reinigen und Desinfizieren des Hydromassage-Systems mit Desinfektionsautomatik

1

Füllstand des Desinfektionsmittels überprüfen.

2



Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.

3



Schließen Sie den Abfluss.

4



Die Schrauben lösen und das Einlasssieb für die Absaugeinrichtung abnehmen. Das Einlasssieb separat reinigen.

5

Die Desinfektionstaste drücken, um den Desinfektionszyklus zu beginnen.

6

Das Desinfektionsmittel tritt aus der Düse des Hydromassage-Systems aus.

Der Desinfektionszyklus ist beendet, wenn das Hydromassage-System mit Wasser durchgespült wird.

7



Desinfektionsmittel in die Überlauföffnung sprühen.

8

Fahren Sie mit den restlichen Desinfektionsschritten gemäß *„Mit Desinfektionsgerät reinigen und desinfizieren (Still Bath und Hydrosound-System)“* auf S. 1 und 2 fort.

9

Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.

10



Drücken Sie die Duschtaste. Überlauföffnung ausspülen.

11

Nach erfolgter Desinfektion das Einlasssieb und die Schrauben wieder anbringen und sie leicht anziehen.



EMPOWERING MOVEMENT

Reinigen und Desinfizieren des Hydromassage-Systems ohne Desinfektionsautomatik

1

Füllstand des Desinfektionsmittels überprüfen.

2

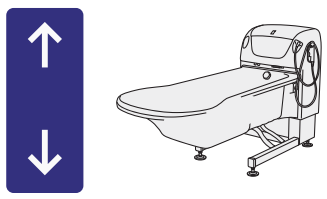

Heben Sie die Badewanne auf eine bequeme Arbeitsposition an.

3



Öffnen Sie den Abfluss.

4



Die Schrauben lösen und das Einlasssieb für die Absaugeinrichtung abnehmen. Das Einlasssieb separat reinigen.

5



Wenn ein Schlauch angeschlossen werden soll, die Düse des Hydromassage-Systems herausziehen.

6



Stecken Sie den Schlauch (falls vorhanden) in den Anschluss des Hydromassage-Systems.

7



Desinfektionsmittel in den Absaugeinlass sprühen, bis Desinfektionsmittel aus dem Schlauch austritt.

8

Desinfektionsmittel in die Überlauföffnung sprühen.

Das Desinfektionsmittel den Anweisungen entsprechend ausreichend lange einwirken lassen.



9

Drücken Sie die Desinfektionstaste, um die Desinfektion zu deaktivieren.

10

Drücken Sie die Duschtaste.

11

Schließen Sie den Duschgriff an den Absaugeinlass an.

12



Den Griff des Hydromassage-Systems bis zur höchsten Stufe aufdrehen.

13

Hebel drücken und durchspülen, bis **klares** Wasser aus dem Schlauch austritt.

14



Entfernen Sie den Schlauch, falls vorhanden.

15



Düse wieder in die Öffnung des Hydromassage-Systems setzen.

16



Überlauföffnung mit Wasser ausspülen.

17

Fahren Sie mit den restlichen Desinfektionsschritten gemäß *„Mit Desinfektionsgerät reinigen und desinfizieren (Still Bath und Hydrosound-System)“* auf S. 1 und 2 fort.

18

Nach erfolgter Desinfektion das Einlasssieb und die Schrauben wieder anbringen und sie leicht anziehen.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

EMPOWERING MOVEMENT