# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797 UKCA 0086

## 洗浄と消毒:


- 消毒ユニットによる洗浄と消毒（通常入浴とハイドロサウンドシステム）、1-2 ページ
- スプレーボトル付き（通常入浴とハイドロサウンドシステム）、3 ページ
- 自動消毒機能付きハイドロマッサージ システム、4 ページ
- 自動消毒を使用しないハイドロマッサージシステム、5 ページ


## 消毒ユニットによる洗浄と消毒（水流を使用しない入浴とハイドロサウンドシステム）

### 目に見える汚れの除去

**1**

消毒液の残量をチェックします。

**2**

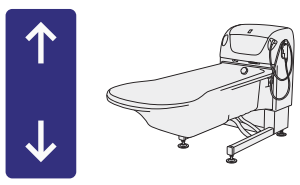

浴槽を作業しやすい位置まで上げます。

**3**

すべての機能がオフになっていることを確認してください。

**4**



排水口を開きます。すべての付属品を取り外して、浴槽の底に置きます。

**5**

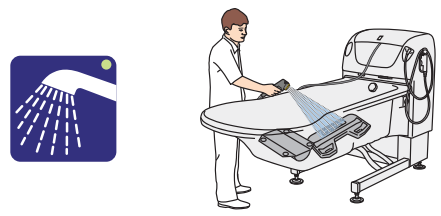

浴槽と付属品に水を掛けてすすぎ、目に見える残留物を取り除きます。付属品の向きを変えて、もう一度すすぎます。

### 以下を洗浄します

**6**

保護用手袋とめがねを付けてください。

**7**



消毒スプレーハンドルを持ち上げます。

**8**

消毒ボタンを押します。

**9**

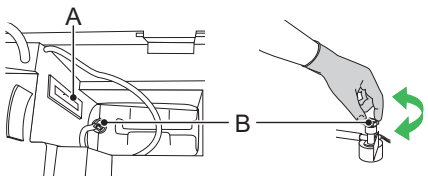


取扱説明書に従って、流量計 (A) が正しい混合値を示すまで、消毒液を浴槽にスプレーします。必要に応じて調整します (B)。

**10**

°C (°F)

消毒液の泡が消えるように、水温を約 25 °C (77 °F) に調節します。

**11**

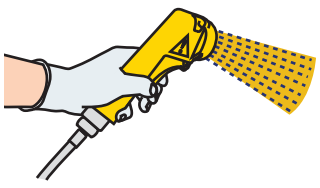

排水口に消毒液をスプレーします。ブラシで排水管をこすります。

**12**



排水口を閉じます。

**13**



浴槽のすべての表面と付属品のすべての側面に消毒液をスプレーします。

**14**



オーバーフロー排水口表面に噴霧します。

**15**

消毒ボタンを押してオフにします。

**16**



柔らかい毛のブラシで浴槽の表面、外した部品、付属品を十分にこすります。

**17**



排水口を開きます。

**18**



水温 25 °C（77 °F）の水を十分に使って、すべての部品を洗い流します。

**19**

布を消毒薬に浸し、他の接触部分をすべて拭きます：
浴槽の外側、ハンドコントロール、メタルセンサーノブ。

**20**



新しい布を水で濡らし、消毒液を拭き取ります。適宜、布を流水ですすいでください。

*2 ページの「通常入浴とハイドロサウンドシステムの消毒」に進みます。*



arjo EMPOWERING MOVEMENT

## 消毒

**21**

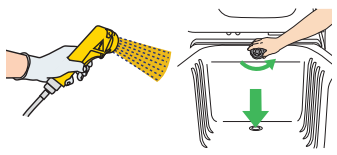

排水口に消毒液をスプレーします。排水口を閉じます。

**22**

浴槽のすべての表面と付属品のすべての側面に消毒液をスプレーします。

消毒液の使用説明書に従って、適切な消毒液料を適切な時間で使用してください。



**23**

消毒ボタンを押して、消毒サイクルを終了します。

**自動消毒のみ：**
事前に設定された消毒時間がまだ経過していなければ、その他の機能は、2-10 分間（型式によって異なります）無効になります。

**24**



消毒スプレーハンドルを元に戻します。

**25**



排水口を開きます。
水温 25 °C（77 °F）の水ですべての部品をきれいに洗い流します。

**26**

消毒液に浸した布で、浴槽の外側、ハンドコントロール、金属製感覚ノブなど、他のすべての接触面を拭きます。

消毒液の使用説明書に従って、適切な消毒液の量を適切な時間で使用してください。



**27**

新しい布を水で濡らし、消毒液を拭き取ります。適宜、布を流水ですすいでください。



**28**

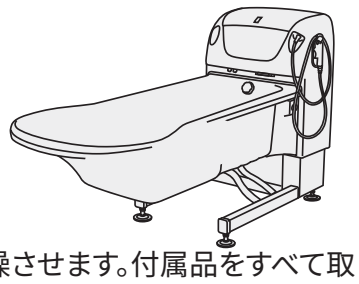

自然乾燥させます。付属品をすべて取り付けます。



arjo
EMPOWERING MOVEMENT

# スプレーボトルによる洗浄と消毒

## 目に見える汚れの除去

**1**



浴槽を作業しやすい位置まで上げます。

**2**

すべての機能がオフになっていることを確認してください。

**3**



排水口を開きます。
すべての付属品を取り外して、浴槽の底に置きます。

**4**

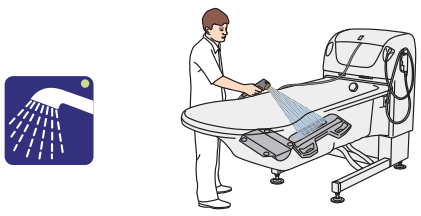

浴槽と付属品に水のシャワーを掛けてすすぎ、目に見える残留物を取り除きます。
付属品の向きを変えて、もう一度すすぎます。

## 以下を洗浄します

**5**

保護用手袋とめがねを付けてください。

**6**

排水口に消毒液をスプレーします。ブラシで排水管をこすります。

**7**



排水口を閉じます。

**8**



浴槽のすべての表面と付属品のすべての側面に消毒液をスプレーします。

**9**



オーバーフロー排水口の表面にスプレーします。

**10**



柔らかい毛のブラシで浴槽の表面、外した部品、付属品を十分にこすります。

**11**



排水口を開きます。

**12**

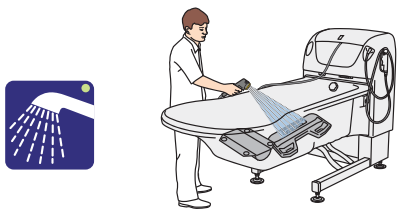

水温 25 °C (77 °F) の水を十分に使って、すべての部品を洗い流します。

**13**

布を消毒薬に浸し、他の接触部分をすべて拭きます：
浴槽の外側、ハンドコントロール、メタルセンサーノブ。



**14**

新しい布を水で濡らし、消毒液を拭き取ります。適宜、布を流水ですすいでください。



## 消毒

**15**

排水口に消毒液をスプレーします。排水口を閉じます。

**16**

浴槽のすべての表面と付属品のすべての側面に消毒液をスプレーします。



**17**

消毒液の使用説明書に従って、適切な消毒液の量を適切な時間で使用してください。

**18**



排水口を開きます。

**19**

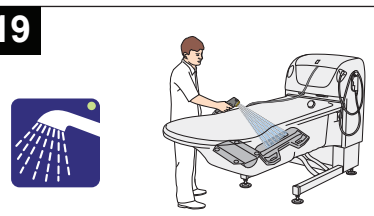

水温 25 °C (77 °F) の水を十分に使って、すべての部品を洗い流します。

**20**

布を消毒薬に浸し、他の接触部分をすべて拭きます：
浴槽の外側、ハンドコントロール、メタルセンサーノブ。

**21**

消毒液の使用説明書に従って、適切な消毒液の量を適切な時間で使用してください。

**22**

新しい布を水で濡らし、消毒液を拭き取ります。適宜、布を流水ですすいでください。



**23**

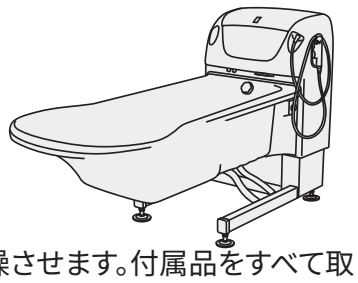

自然乾燥させます。付属品をすべて取り付けます。



arjo
EMPOWERING MOVEMENT

# 自動消毒機能付きハイドロマッサージシステムの洗浄と消毒

**1**

消毒液の残量をチェックします。

**2**



浴槽を作業しやすい位置まで上げます。

**3**



排水口を閉じます。

**4**



ネジを外して、吸入口のスクリーンを取り外します。吸入口のスクリーンを別々に洗浄します。

**5**

消毒ボタンを押して、消毒サイクルを開始します。

**6**

消毒液はハイドロマッサージシステムのノズルから出てきます。

消毒サイクルは、ハイドロマッサージシステムが水ですすがれて終了となります。

**7**



オーバーフロー排水口内にも消毒液を噴霧します。

**8**

この QRG の 1-2 ページの「*消毒ユニットによる洗浄と消毒（水流を使用しない入浴とハイドロサウンドシステム）*」に従って、残りの消毒手順を続行します。

**9**

消毒液の使用説明書に従って、適切な消毒液の量を適切な時間で使用してください。

**10**



シャワーボタンを押します。
表面オーバーフロー排水口を水ですすいでください。

**11**

消毒が完了したら、吸引口のスクリーンをネジで取り付け、ゆっくりと締めます。





EMPOWERING MOVEMENT

# 自動消毒を使用しないハイドロマッサージシステムの洗浄と消毒

**1**

消毒液の残量をチェックします。

**2**

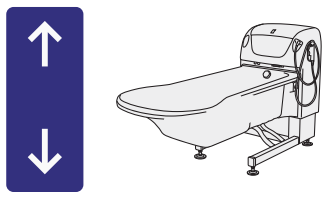

浴槽を作業しやすい位置まで上げます。

**3**



排水口を開きます。

**4**



ネジを外して、吸入口のスクリーンを取り外します。吸入口のスクリーンを別々に洗浄します。

**5**



トリートメントホースを接続する場合は、ハイドロマッサージシステムのノズルを取り外してください。サージシステムノズルを引き抜いてください。

**6**



トリートメントホースを ハイドロマッサージシステムの排水口に挿入します。

**7**



消毒液がホースから出てくるまで、消毒液を吸引口にスプレーします。

**8**

オーバーフロー排水口内にも消毒液を噴霧します。

消毒液の使用説明書に従って、適切な消毒液の量を適切な時間で使用してください。



**9**

消毒ボタンを押して、消毒をオフにします。

**10**

シャワーボタンを押します。

**11**

シャワーハンドルを吸入口に接続します。

**12**



ハイドロマッサージシステムのノブを最高の強度に回します。

**13**

ホースから**きれいな**水が出てくるまですすぎます。

**14**



ホースがある場合は取り外します。

**15**



ノズルをハイドロマッサージシステムの排水口に戻します。

**16**



オーバーフロー排水口の表面を水ですすいでください。

**17**

この QRG の 1-2 ページの「*消毒ユニットによる洗浄と消毒（水流を使用しない入浴とハイドロサウンドシステム）*」に従って、残りの消毒手順を続行します。

**18**

消毒が完了したら、吸引口のスクリーンをネジで取り付け、ゆっくりと締めます。



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com



EMPOWERING MOVEMENT