Carevo

Reinigung

Zugelassene Desinfektionsmittel:
- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Zubehör
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sprühflasche (falls kein Shower Panel verfügbar ist)
- Desinfektionsflüssigkeit
- Einmalhandtücher
- Weiche Reinigungsbürste
- Flaschenbürste

1

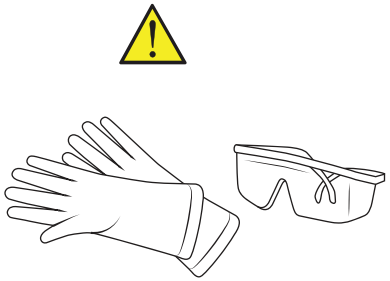

Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.

2

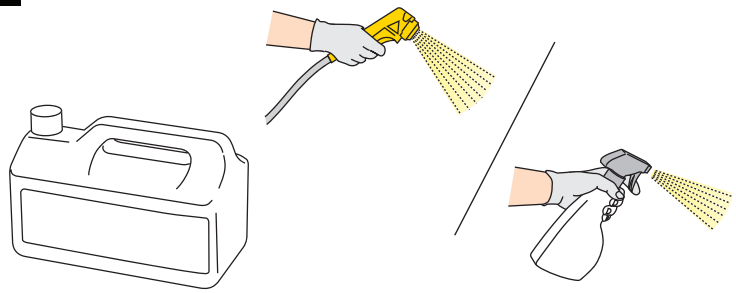

Prüfen Sie, dass das Desinfektionsmittel gemäß den folgenden Anweisungen gemischt ist:
- Kennzeichnung auf der Desinfektionsmittelflasche oder
- Mischverhältnis in der Gebrauchsanweisung des Shower Panel

3

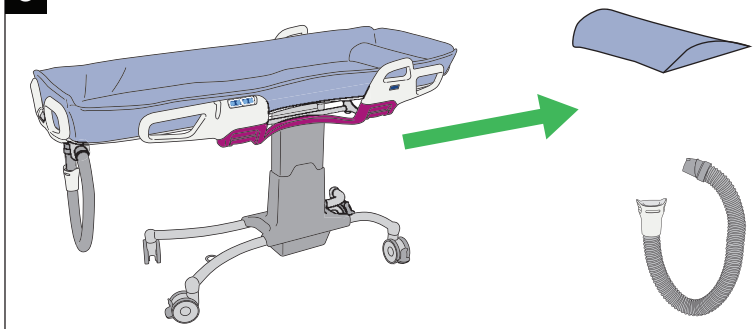

Entfernen Sie den unteren Ablauf und das Kissen.

4

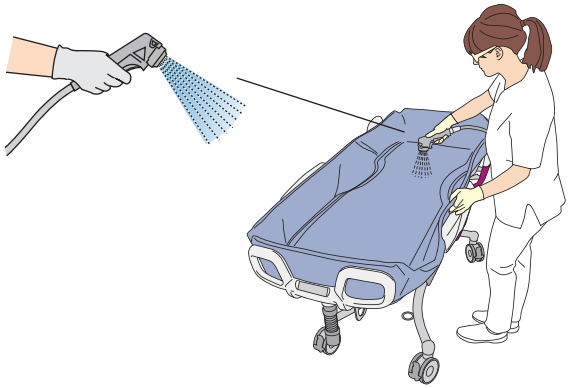

Mit Wasser abspülen. Beginnen Sie dabei oben an der Auflage und gehen Sie bis zu den Lenkrollen hinunter.

5

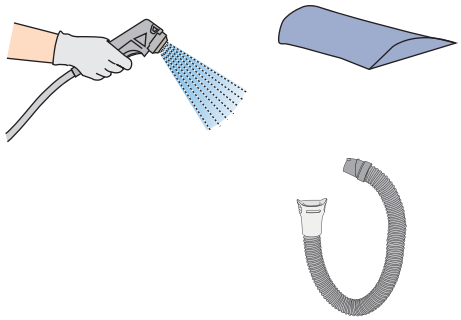

Spülen Sie den unteren Ablauf und das Kissen mit Wasser.

Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

EMPOWERING MOVEMENT

Reinigung (Fortsetzung)

6

Verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste mit Desinfektionsmittel. Beginnen Sie mit der Reinigung oben an der Auflage und gehen Sie bis zu den Lenkrollen hinunter.
Verwenden Sie eine mit Desinfektionsmittel getränkte Flaschenbürste.
Reinigen Sie den oberen Ablauf.

7

Reinigen Sie die Unterseite der Auflage, die Auflageflächen und das Äußere des oberen Ablaufs.

8

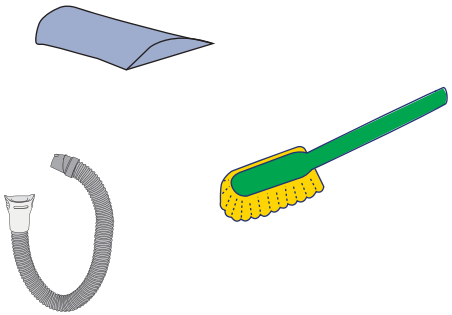

Verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste.
Schrubben Sie das Kissen und den unteren Ablauf separat.
Vermeiden Sie den Kontakt mit der Auflage, solange das Kissen noch nicht desinfiziert wurde.

Desinfizierung

9

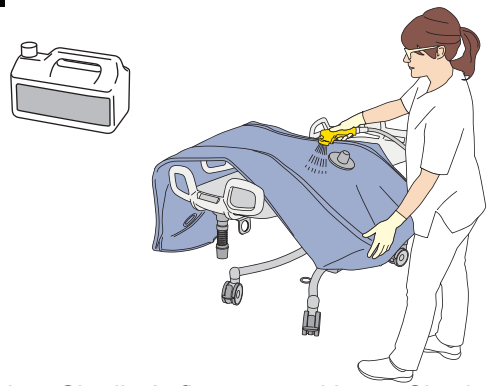

Heben Sie die Auflage an und legen Sie sie über die Fußbegrenzung und die Seitenstützen.
Die Unterseite der Auflage zeigt nach oben.
Besprühen Sie die Unterseite der Auflage mit Desinfektionsmittel.

10

Reinigen Sie die Unterseite der Auflage mit einem Einmalhandtuch.

11

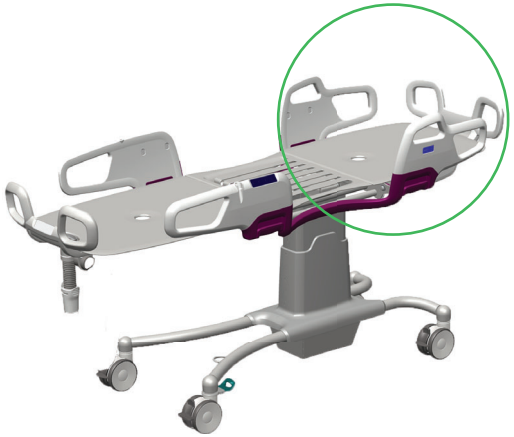

Besprühen Sie die folgenden Teile am Kopfende mit Desinfektionsmittel und reinigen Sie diese Teile:
Kopfbegrenzung, Seitenstützen, Stützfläche und Flexi-Zone mit einem Einmalhandtuch.

Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Desinfizierung (Fortsetzung)

12

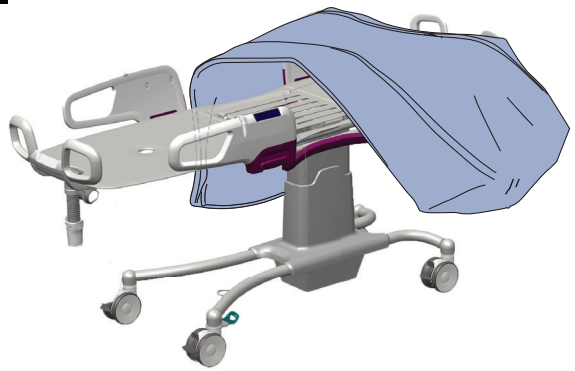

Legen Sie die desinfizierte Unterseite der Auflage über die desinfizierte Kopfbegrenzung und die desinfizierten Seitenstützen. Die nicht desinfizierte Innenseite der Auflage zeigt nach oben.
Ziehen Sie die eingedrückten Ecken der Auflage heraus.

13

Besprühen Sie die Innenseite der Auflage mit Desinfektionsmittel und reinigen Sie sie mit einem Einmalhandtuch.
Drücken Sie die Ecken der Auflage wieder zurück in ihre ursprüngliche Position.

14

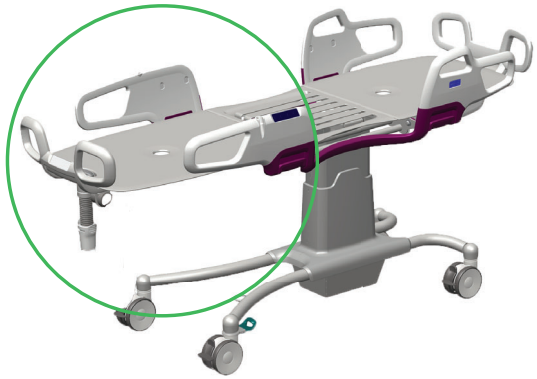

Besprühen Sie die folgenden Teile am Fußende mit Desinfektionsmittel und reinigen Sie diese Teile: Fußbegrenzung, Seitenstützen, Stützfläche, Flexi-Zone und oberer Ablauf.

15

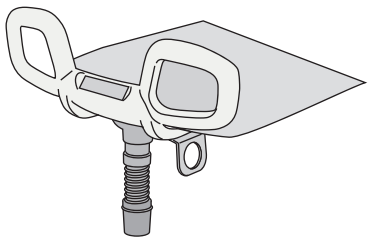

Besprühen Sie den oberen Ablauf mit Desinfektionsmittel und reinigen Sie ihn mit einer Flaschenbürste.

16

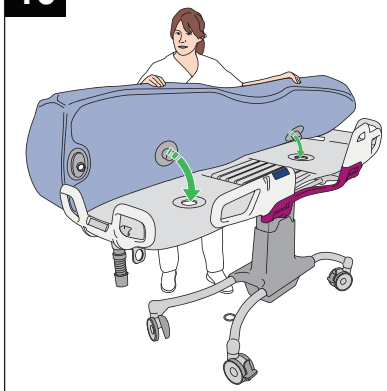

Platzieren Sie die Auflage in ihrer ursprünglichen Position.

17

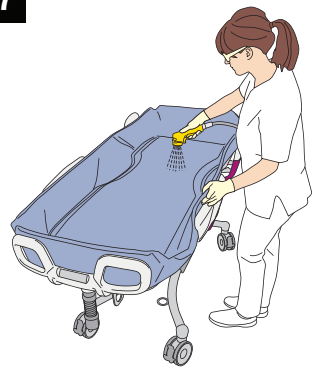

Sprühen Sie Desinfektions-mittel darauf.
Beginnen Sie dabei oben an der Auflage und gehen Sie bis zu den Lenkrollen hinunter.

18

Verwenden Sie ein Einmalhandtuch zur Reinigung.
Beginnen Sie dabei oben an der Auflage und gehen Sie bis zu den Lenkrollen hinunter.

19

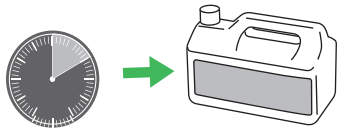

Achten Sie auf eine ausreichende Einwirkzeit des Desinfektionsmittels.

Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Desinfizierung (Fortsetzung)

20

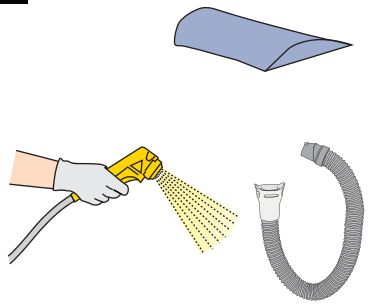

Besprühen Sie das Kissen und den unteren Ablauf mit Desinfektionsmittel und reinigen Sie diese Teile gesondert mit einem Einmalhandtuch.

21

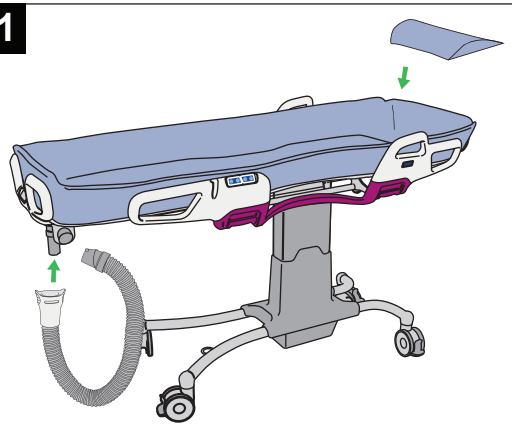

Verbinden Sie den unteren Ablauf mit dem oberen Ablauf und legen Sie das Kissen auf die Auflage.

22

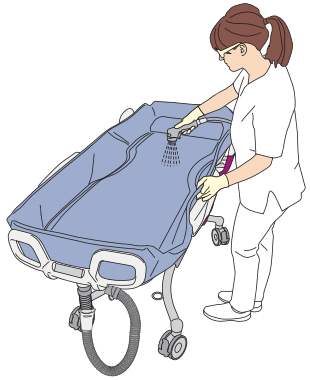

Spülen Sie alle Komponenten mit kaltem Wasser ab, bis keine Rückstände des Desinfektionsmittels mehr bestehen. Beginnen Sie dabei oben an der Auflage und gehen Sie bis zu den Lenkrollen hinunter. Spülen Sie unter der Matratze.

23

Reiben Sie jede Komponente mit einem Einmalhandtuch trocken.