Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

CE 2797

Limpe e desinfete diariamente.
Limpe e desinfete antes de utilizar com o paciente seguinte.

Acessórios necessários:

- Luvas de proteção
- Óculos de proteção
- Garrafa aspersora com desinfetante (se não estiver disponível um sistema de desinfeção integrado)
- Garrafa aspersora (ou manípulo de chuveiro) com água
- Panos - molhados e secos
- Toalhas descartáveis
- Escova macia
- Escova macia com cabo comprido

NOTA

O procedimento de limpeza e desinfeção é ilustrado com Miranti e um sistema de desinfeção integrado como exemplo.

AVISO

Para evitar danos nos olhos e na pele, utilize sempre óculos e luvas de proteção. Se o contacto ocorrer, lave com água abundante. Se os olhos ou pele ficarem irritados, contacte um médico. Leia sempre as Instruções de Utilização e a Ficha de dados de segurança (FDS) do desinfetante.

Para evitar a contaminação cruzada, respeite sempre as instruções de desinfeção contidas nas Instruções de Utilização.

Para evitar irritações nos olhos ou na pele, nunca desinfete na presença de um paciente.

Remover resíduos visíveis

1

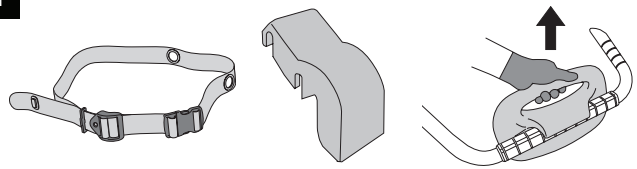

Miranti: Retire o apoio para a cabeça, a almofada de apoio das coxas, a pega de segurança do paciente e os cintos de segurança.
Bolero: Retire o colchão e os cintos de segurança.
Alenti: Retire o apoio das costas e o cinto de segurança.
Calypso: Retire os assentos, a inserção para o assento, o apoio das costas e o cinto de segurança.

Coloque os acessórios no fundo da banheira.

2

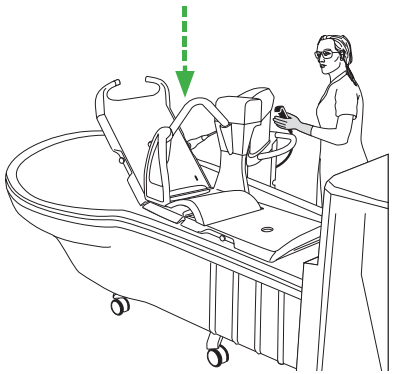

Posicione o elevador de higiene por cima da banheira e desça-o.

3

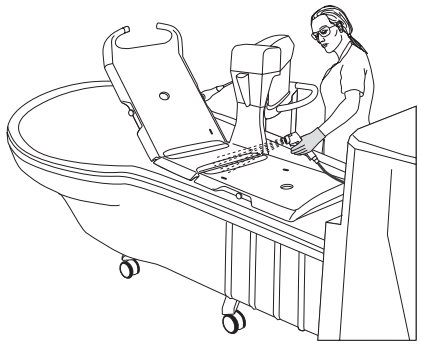

Limpe os resíduos visíveis com um pano embebido em água ou molhando com o chuveiro e esfregando com uma escova. Limpe o elevador de higiene começando de cima para baixo. Limpe todas as peças retiradas.

Continue com os passos na página seguinte

arjo with people in mind

Limpeza

4

Coloque as luvas e os óculos de proteção.

5

Leia atentamente as instruções em separado do sistema de desinfeção e do desinfetante utilizado.

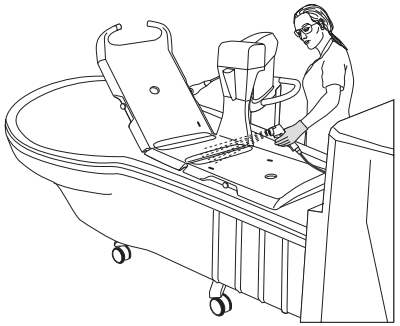

Pulverize desinfetante no elevador de higiene e em todas as peças retiradas.
Utilize uma garrafa aspersora com desinfetante ou utilize o sistema de desinfeção integrado da banheira.

6

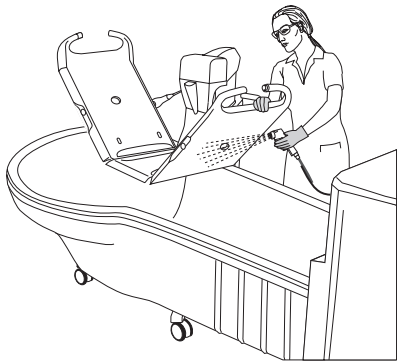

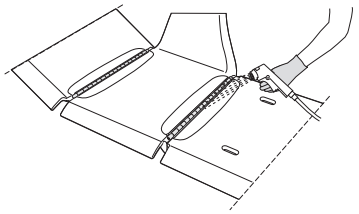

Esfregue bem com uma escova embebida em desinfetante, especialmente nas pegas, no comando manual, nas dobradiças e na parte inferior do elevador de higiene.

7

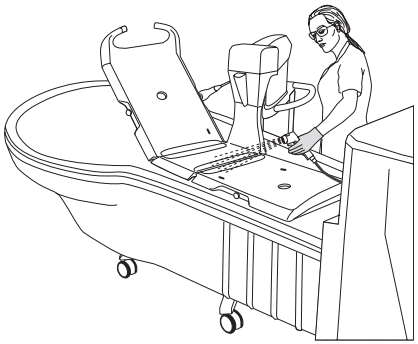

Lave com água do chuveiro (aprox. 25 °C (77 °F)) ou pulverize com água e limpe com um pano limpo.

8

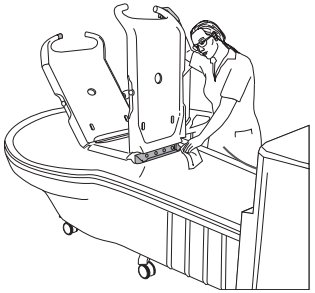

Embeba um pano em desinfetante e limpe todas as outras áreas.

9

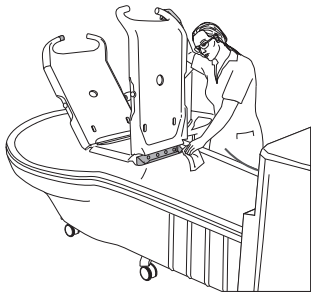

Molhe um novo pano com água e remova todos os vestígios de desinfetante nas outras áreas.
É necessário passar o pano ocasionalmente por água corrente.

10

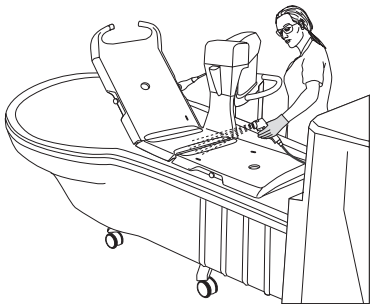

Se não for possível remover todo o desinfetante, pulverize água sobre a parte afetada e limpe-a com uma toalha descartável até que todo o desinfetante seja removido.

Continue com os passos na página seguinte

arjo
with people in mind

Desinfeção

11

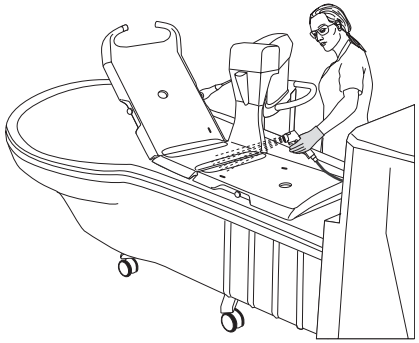

Pulverize desinfetante no elevador de higiene e em todas as peças retiradas.

12

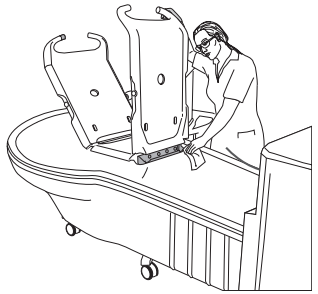

Embeba um pano em desinfetante e limpe todas as outras áreas.

13

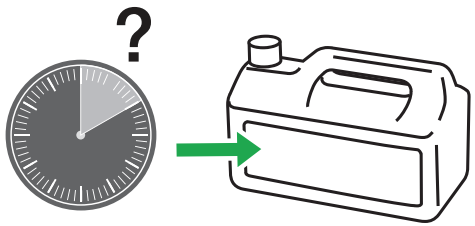

Deixe o desinfetante atuar durante o tempo indicado nas instruções do desinfetante.

14

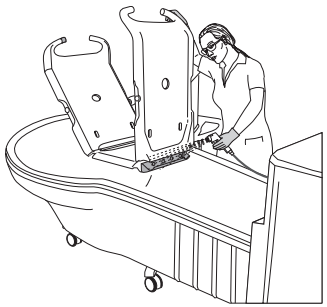

Lave com o chuveiro ou pulverize água e limpe com um pano limpo para remover todos os vestígios de desinfetante do elevador de higiene, do chassis e de todas as peças removidas. É necessário passar o pano ocasionalmente por água corrente.

15

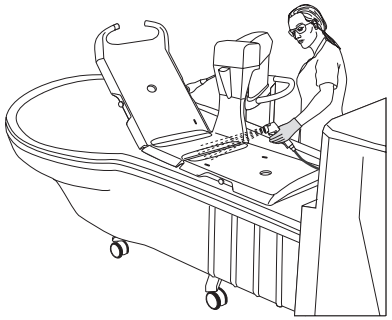

Se não for possível remover todo o desinfetante, pulverize água sobre as partes afetadas e limpe-as com uma toalha descartável até que todo o desinfetante seja removido.

16

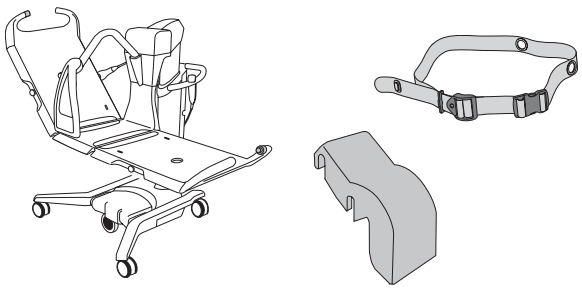

Deixe secar todas as peças.