Flowtron ACS900

Monitorização da conformidade

Monitorização da conformidade; regista e apresenta a terapia real, bem como o tempo não conforme. Alerta aquando da remoção de vestuário para facilitar a monitorização e documentação da terapia CPI.

Ativar/Desativar a monitorização da conformidade

1. Configurar a monitorização da conformidade:
   - Certifique-se de que não está ligado nenhum acessório à bomba.
   - Prima e mantenha premido o botão de controlo do meio para aceder ao ecrã de configuração.



2. Prima o botão de controlo esquerdo para percorrer as opções:
   - LIGADO com alerta sonoro ativado
   - LIGADO com alerta sonoro desativado
   - DESLIGADO (o tempo de funcionamento da bomba é apresentado em vez do tempo de terapia acumulado)



3. Prima o botão de controlo do meio para selecionar a opção apresentada.

Repor a monitorização da conformidade (tempo de terapia acumulado)

1. Com a bomba em Modo de espera, prima o botão de controlo direito e mantenha premido durante 2 segundos. O tempo pisca durante 2 minutos. Prima o botão de controlo do meio e mantenha premido durante 3 segundos para repor o tempo de terapia em zero.
2. Prima o botão de controlo direito de novo para confirmar. Se o botão não for premido dentro de dois minutos, o temporizador NÃO será reposto e voltará a mostrar os dados originais.

Iniciar a terapia

1. Ajuste o acessório ao paciente.



2. Ligue o acessório à bomba.

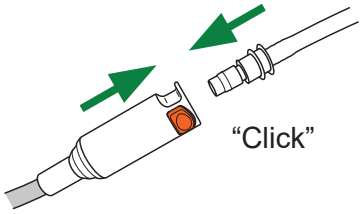

3. Prima o botão de controlo do meio para iniciar a terapia.



EMPOWERING MOVEMENT

Leia o visor

1. Durante a utilização, o ACS900 monitoriza cada insuflação para se certificar de que está a administrar profilaxia ao paciente. O tempo de terapia acumulado é apresentado no canto inferior direito.

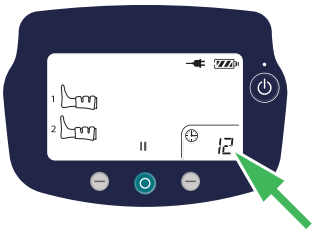

2. Se a bomba detetar que o acessório foi removido do membro, enquanto a bomba está no modo de funcionamento, o gráfico do membro correspondente pisca.

Os prestadores de cuidados são alertados para a ausência de profilaxia.

A sequência de notificações:

- O ícone da perna começa a piscar e o tempo de não conformidade aparece no ecrã.
- Após 3 ciclos, o triângulo de aviso aparece no ecrã e o LED verde começa a piscar.
- Após 10 minutos, o LED verde intermitente passa a amarelo fixo com um alarme sonoro opcional.

Além disso, a bomba irá contar e mostrar durante quanto tempo a terapia não foi realizada (tempo de não conformidade). Isto é apresentado inicialmente em minutos intermitentes.

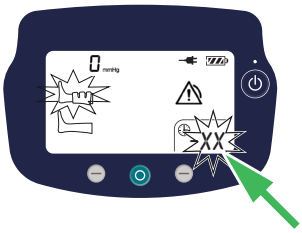

3. Após 1 hora de não conformidade monitorizada, o visor muda para apresentar o tempo em horas intermitentes.



4. Prima o botão de controlo direito para ver os minutos adicionais até à hora. Um "–" é apresentado no visor antes dos minutos.



Retificar aviso/alerta

1. Para eliminar o aviso/alerta de monitorização da conformidade, volte a ajustar os acessórios removidos no membro.

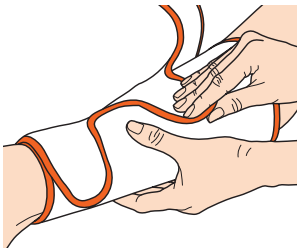

2. O tempo de não conformidade é eliminado automaticamente quando a bomba deteta que o acessório foi reajustado ao membro. A bomba volta à apresentação do tempo de terapia acumulado e continua a contar a partir de onde parou.

3. Em alternativa, faça uma pausa e reinicie a bomba.