




Flowtron ACS900

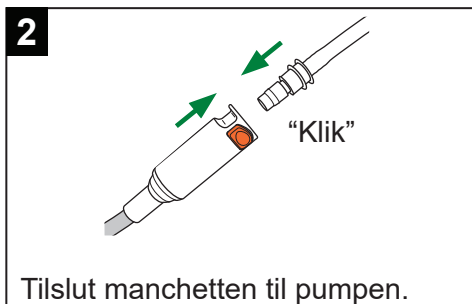


Start behandling

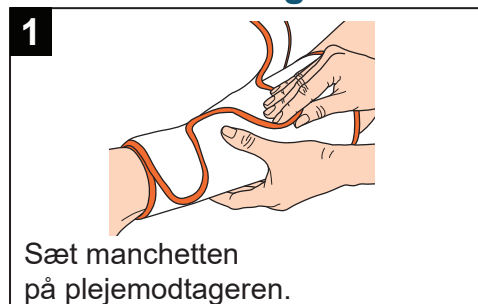

Stop behandling

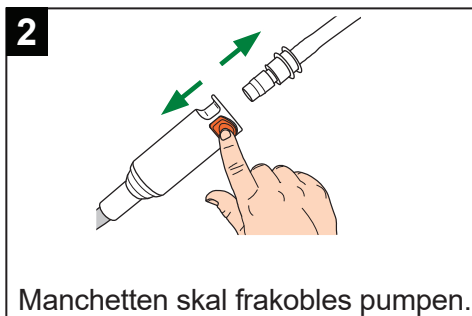

Aflæs driftstiden for plejemodtageren — timer og minutter (fra softwareversion 2.210)

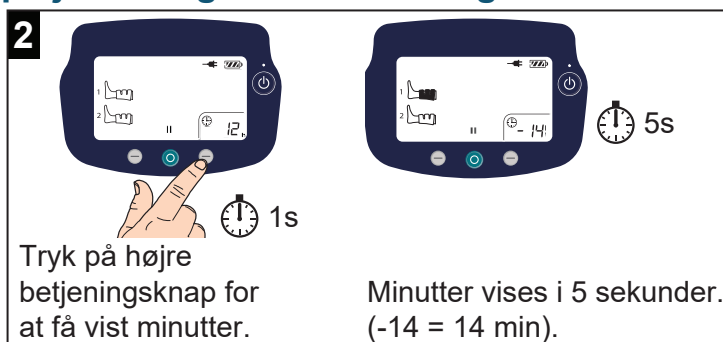

Nulstil driftstiden for plejemodtageren — timer og minutter



Sådan ændres lydstyrken på lydalarmer

