

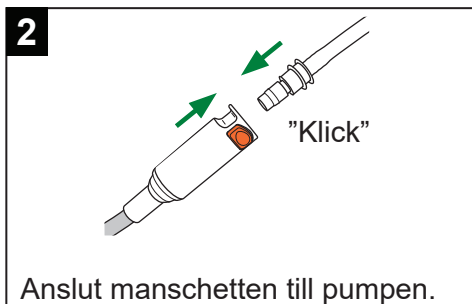


Flowtron ACS900

Starta behandling

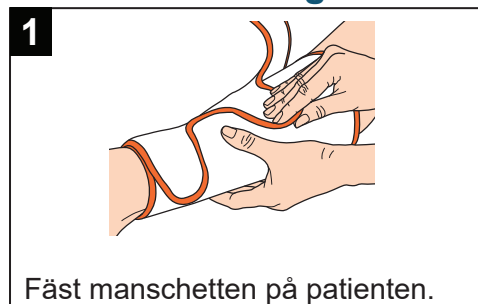


Stoppa behandling

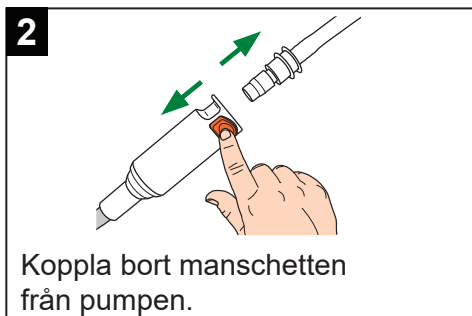

Läsa av timern för behandlingstid – timmar och minuter (från programvaruversion 2.210)



Återställa timern för behandlingstid – timmar och minuter

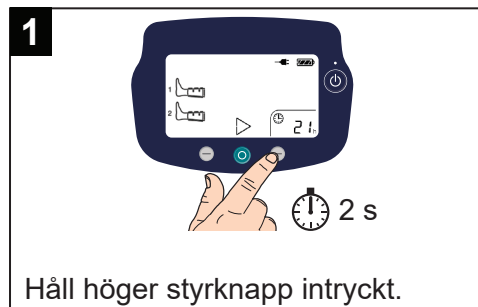

Ändra volym för ljudlarm

