Flowtron ACS900

CE 2797

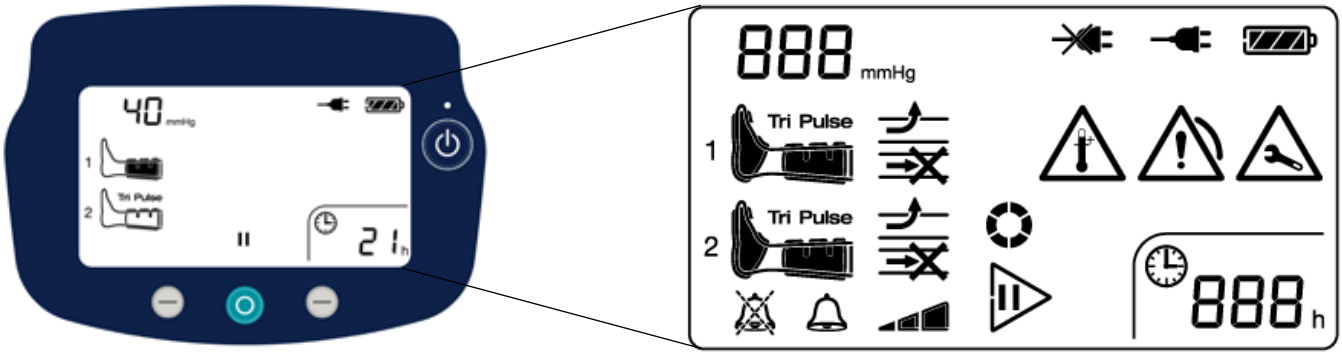

電源インジケータ
消灯：主電源が切れている。
緑色に点灯：AC電源に接続されています。

電源ボタン
スイッチをオンにするには：約2秒間押し続けると、ポンプは直接スタンバイ状態になります。
OFFにするには：約2秒間押し続けます。

コントロールボタン（中）
ボタンを押して、運転を開始します。
ボタンを長押しして、運転を停止します。

コントロールボタン（左）
ボタンを押すと、アラームがミュートします。
ボタンを長押しして、アラームの音量を設定できます。

コントロールボタン（右）
ボタンを長押しすると、累積作動時間のリセットモードになります。

888 mmHg **カフ圧力インジケーター**

カフ種類と状態（加圧・休止）インジケーター

接続中（休止状態）	接続中（加圧状態）	
		フットカフ
		ユニフォームショートカフ（または下腿と大腿）
Tri Pulse	Tri Pulse	シーケンシャル (Tri Pulse) 下腿（または下腿と大腿）

1
2 **チューブセットコネクタ番号**

アラームミュートインジケーター

アラーム状態インジケーター
アラーム中：アラームをミュートできます。

警告表示とアラームインジケーター

運転の中断を引き起こす恐れがあるアラームを検出

低圧またはカフもしくはチューブから空気が漏れている

接続チューブのねじれや詰まり

高温

ポンプ本体の異常を検出または定期点検が必要

ボリュームインジケーター

待機 – インジケータを初期化中

運転開始インジケーター
1つ以上のカフが接続されて入る場合、スタンバイ時に表示されます

運転停止インジケーター
運転モード時に表示されます

AC電源表示

ポンプは電源に接続されています

ポンプは電源に接続されていません

バッテリーインジケーター

Battery Empty
（バッテリー残量がありません）

Battery ¼ Full
（バッテリー ¼ 充電済み）

Battery ½ Full
（バッテリー ½ 充電済み）

Battery ¾ Full
（バッテリー ¾ 充電済み）

バッテリーフル充電済み

888 h **運転時間インジケーター**

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

526936JA_04 • 02/2021

arjo
with people in mind