FLOWTRON ® VTE予防

カフ（ガーメント）のサイズ選択と装着ガイド

VTEを適切に予防するには、カフ（ガーメント）が患者の肢に正しくフィットすることが重要です。以下の指示に従い、患者の肢の測定に基づきサイズを選択する必要があります。

カフ（ガーメント）のサイズと測定場所

大腿-下腿丈のカフ（ガーメント）：
大腿付け根に近い最も太い部分の周径を測定します。*

下腿丈のカフ（ガーメント）：
下腿の最も太い部分の周径を測定します。

フットカフ（ガーメント）：
患者の靴のサイズを参考にします。

測定箇所



	大腿-下腿カフ（ガーメント）	品番	大腿上部周径
1		DVT30	≤ 71 cm
		DVT40	≤ 89 cm
		L503-M	≤ 71 cm
		TRP30	≤ 71 cm
		TRP40	≤ 89 cm

	下腿カフ（ガーメント）	品番	下腿周囲
2		DVT5	≤ 36 cm
		DVT10	≤ 43 cm
		DVT20	≤ 58 cm
		DVT60L	≤ 81 cm
		L501-M	≤ 43 cm
		TRP10	≤ 43 cm
		TRP20	≤ 58 cm
		TRP60L	≤ 81 cm

フットカフ（ガーメント）

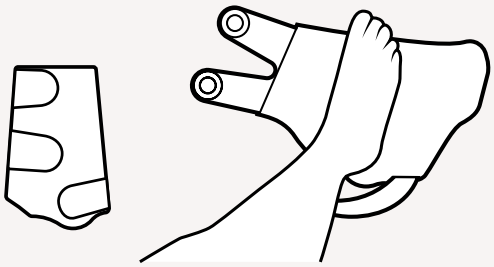

品番	靴のサイズ			
	US（M）	US（F）	EURO	UK
FG100	≤ 7	≤ 9	≤ 40	≤ 7
FG200	≥ 7.5	≥ 9.5	≥ 41	≥ 7.5

* 通常は大腿周径の最も太い部分です。この測定は、実際にカフ（ガーメント）が装着される場所を測定するため、大腿用カフ（ガーメント）に使用される下肢周りの測定値は、実際のカフ（ガーメント）の周囲よりも大きくなります。

注記：

- すべてのカフ（ガーメント）は、一人の患者専用での使用を想定しています。
- 下腿カフ（ガーメント）と大腿カフは2枚一組になっており、左右どちらの脚にも使用できます。フットカフ（ガーメント）は個別に梱包されており、左右どちらの足にも使用できます。
- システムを使用している間は、患者の皮膚を頻繁に観察し、踝部や踵部などの骨隆起部に特に注意を払う必要があります。
- 適応および禁忌については、カフ（ガーメント）の取扱説明書をお読みください。

下腿カフ（ガーメント）
アプリケーションガイド

1



準備
密閉された袋からカフ（ガーメント）を取り出し、Velcro® ファスナータブを外して広げます。

2



膨張式ブラダーを患者の下腿の真下に配置します。チューブが足首、かかと、足の下にないことを確認します。

3



固定
カフ（ガーメント）を脚にしっかりと巻き付けて、Velcro® ファスナータブで固定します。皮膚や下層組織に継続的な圧迫点が生じないようカフ（ガーメント）を配置してください。

大腿カフ（ガーメント）
アプリケーションガイド

1



準備
密閉された袋からカフ（ガーメント）を取り出し、Velcro® ファスナータブを外して広げます。

2



カフ（ガーメント）の膨張部を患者の下腿と大腿の下に配置します。チューブが足首、かかと、足の下にないことを確認します。

3



固定
カフ（ガーメント）を脚にしっかりと巻き付けて、Velcro® ファスナータブで固定します。皮膚や下層組織に継続的な圧迫点が生じないようカフ（ガーメント）を配置してください。

フットカフ（ガーメント）
アプリケーションガイド

1



準備
密閉された袋からカフ（ガーメント）を取り出し、Velcro® ファスナータブを外して広げます。

2

カフ（ガーメント）の中央に足を配置し、図のようにカフの背面がかかとと一直線になるようにします。

3



固定
シングルフラップを足の上部にかぶせ、固定します（1）。
上部フラップを足の上に折りたたみ、Velcro® ファスナー（2）を固定します。足にフィットしつつ、快適性を保つようにします。
パッド入りヒールストラップをかかとの後ろに巻き付け、Velcro® ファスナー（3）で固定します。
ストラップを締めてカフ（ガーメント）を固定します。

4



接続
スナップロックコネクターを使用して、ポンプの一体型チューブセットの1つにカフ（ガーメント）のチューブを接続します。「カチッ」と音がします。

5



開始
Flowtronポンプで治療を開始します。ご使用のポンプの取扱説明書をお読みください。

February 2023. Arjo が提供する機器および製品には、目的に合わせて設計された Arjo 設計部品のみを使用してください。当社ポリシーの1つに継続的な開発を掲げているため、予告なしにデザインや仕様を変更することがあります。® と ™ は、Arjo グループの企業に属する商標です。
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
アルジョ・ジャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-8 ランディック第2虎ノ門ビル9階 Tel: 03-6435-6401 · Fax:03-6435-6402

Arjo.A00661.1.0.JP.JA